

(สำเนา)

ประกาศคณะกรรมการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 12 รายการ

ด้วยคณะกรรมการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จะทำการขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 12 รายการ (ตามรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศ) โดยวิธีขายทอดตลาดครั้งนี้ มีรายละเอียดวิธีการและเงื่อนไข ต่อไปนี้

1. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ขายทอดตลาด

1.1 ผู้ที่มีความประสงค์จะซื้อและตรวจสอบสภาพพัสดุนายทอดตลาด ให้ไปพบกับเจ้าหน้าที่คณะกรรมการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันที่ 16 กันยายน 2557 เวลา 9.30 น. นัดพร้อมกันที่ งานพัสดุ อาคารบริหารวิชาการรวม ชั้น 4 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1.2 ในการขายทอดตลาดให้ไปเสนอราคาพร้อมกัน ณ ห้องประชุม MT 405 อาคารบริหารวิชาการรวม ชั้น 4 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันที่ 16 กันยายน 2557 เวลา 11.00 น.

2. เงื่อนไขการประมูลขายทอดตลาด

2.1 ผู้ที่มีความประสงค์จะซื้อจะต้องยื่นเอกสารต่อคณะกรรมการ ดังนี้

2.1.1 กรณีบุคคลธรรมดา ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2.1.2 กรณีนิติบุคคล ได้แก่ สำเนาหนังสือบริษัทหรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทหรือทะเบียนพาณิชย์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และหนังสือมอบอำนาจในกรณีที่มอบหมายให้บุคคลอื่นประมูลราคาและลงนามในเอกสารแทนผู้มีอำนาจ

โดยผู้ประสงค์จะซื้อพัสดุจะต้องวางเงินค้ำประกันการสุ้ราคาพัสดุนั้นเป็นเงินสด เป็นเงิน 2,000 บาท เพื่อประกันการสุ้ราคาพัสดุ โดยคณะกรรมการจะออกเอกสารรับเงินชั่วคราวไว้เป็นหลักฐานโดยผู้เข้าร่วมเสนอราคาซื้อจะได้รับเงินค้ำประกันคืนหลังจากเสร็จสิ้นการขาย หรือวันถัดไป

2.2 ให้ผู้ประสงค์ซื้อเข้าสู่เสนอราคากันโดยวาจา การขายทอดตลาดย่อมสมบูรณ์ เมื่อผู้ขายทอดตลาดแสดงความตกลงด้วยการเคาะไม้ ถ้าคณะกรรมการผู้ขายทอดตลาดได้เคาะไม้ ตกลงขายไปโดยสมบูรณ์แล้ว ผู้ซื้อไม่ชำระเงินหรือวางมัดจำตามข้อตกลงนี้ ผู้ซื้อต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่จะพึงเกิดขึ้น

2.3 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะขายทอดตลาดพัสดุจากราคาต่อรายการ โดยจะพิจารณาขายให้กับผู้ที่เสนอราคาสูงสุดของแต่ละรายการ หากมหาวิทยาลัยฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าราคาที่มีผู้เสนอราคาสูงสุดนั้นยังไม่เพียงพอ เจ้าหน้าที่ผู้ขายทอดตลาดจะถอนพัสดุนั้นออกจากการขายทอดตลาดเสีย โดยงดการขายไว้เพื่อพิจารณาดำเนินการตามที่เหมาะสมต่อไป

2.4 เมื่อตกลงราคาซื้อขายแล้ว คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะกำหนดให้ผู้ซื้อต้องชำระเงินสดทันที หรือจะต้องนำเงินสดมาวางมัดจำ คิดเป็นร้อยละ 25 ของราคาที่ประมูลได้ และต้องชำระเงินที่เหลือให้เสร็จสิ้นภายในกำหนด 7 วันทำการนับแต่วันตกลงราคาซื้อขาย หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัยฯ จะถือว่าสละสิทธิ์และจะทำการรับเงินมัดจำทั้งหมด และจะตัดสิทธิ์ในการขายรอบต่อไป หลังจากนั้นจะดำเนินการขายให้แก่ผู้ที่มีมหาวิทยาลัยฯ เห็นสมควรต่อไป

/2.5 เมื่อผู้ซื้อ...

2.5 เมื่อผู้ซื้อได้นำเงินมาชำระถูกต้องครบถ้วนแล้ว คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะส่งมอบพัสดุดังกล่าวให้ทันที และผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบต่อความเสี่ยงที่ชนะการเสนอราคาออกจากบริเวณที่พัสดุนั้นตั้งอยู่ให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วันทำการ มิฉะนั้น มหาวิทยาลัยฯ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นในภายหลังทั้งสิ้น

2.6 หากทรัพย์สินของคณะเทคนิคการแพทย์เสียหาย ที่เกิดจากการขนย้ายพัสดุ ผู้ประมูลได้จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

ผู้สนใจติดต่อสอบถามและขอรับเอกสารการขายทอดตลาดได้ที่ งานพัสดุ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ หรือ สอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-7428-9104 หรือ โทรสาร หมายเลข 0-7428-9101 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่ <http://medtech.psu.ac.th/th/>

ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2557

(ลงชื่อ) ศิโรช จิตต์สุรงค์
(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรช จิตต์สุรงค์)
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


สำเนาถูกต้อง
ตริณัฐ โสเจยยะ
(นางสาวตริณัฐ โสเจยยะ)
นักวิชาการพัสดุ

เอกสารแนบท้ายประกาศ
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


ลำดับที่	รายการครุภัณฑ์	จำนวน	เลขทะเบียนครุภัณฑ์
1	เครื่องปั่นแยกน้ำเหลือง	1 เครื่อง	C-19/1-โอน
2	Lyophilizer เครื่องเตรียมเชื้อแห้งเพื่อเก็บระยะยาว	1 เครื่อง	C-43-โอน
3	เครื่อง Spectrophotometer	1 เครื่อง	36-540514-โอน/1
4	เครื่อง Spectrophotometer	1 เครื่อง	36-540514-โอน/2
5	เครื่องฟลูออซิโตมิเตอร์ (Flow cytometry), Coulter Epic Elite, USA ประกอบด้วย Printer Laser HP 5m, เครื่องสำรองไฟ และปรับแรงดันอัตโนมัติ ขนาด 5 KVA, Leonics	1 เครื่อง	ร38-0785-001-โอน
6	ตู้อบเลี้ยงเชื้อคาร์บอนไดออกไซด์	1 เครื่อง	36-0646-001-โอน/1
7	ตู้อบเลี้ยงเชื้อคาร์บอนไดออกไซด์	1 เครื่อง	36-0646-001-โอน/2
8	เครื่อง Trans illuminator	1 เครื่อง	35-0611-001-โอน
9	เครื่อง Automatic Analyzer	1 เครื่อง	C-52-โอน
10	เครื่อง Electrolyte analyzer	1 เครื่อง	MT-NS-โอน-1
11	เครื่องชั่งแบบละเอียด	1 เครื่อง	MT-NS-โอน-2
12	เครื่องแยกชนิดเม็ดเลือด (Haematology)	1 เครื่อง	MT-NS-โอน-3

รายการครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 12 รายการ


รายการที่ 1 เครื่องปั่นแยกน้ำเหลือง รหัสครุภัณฑ์ C-19/1 โอน

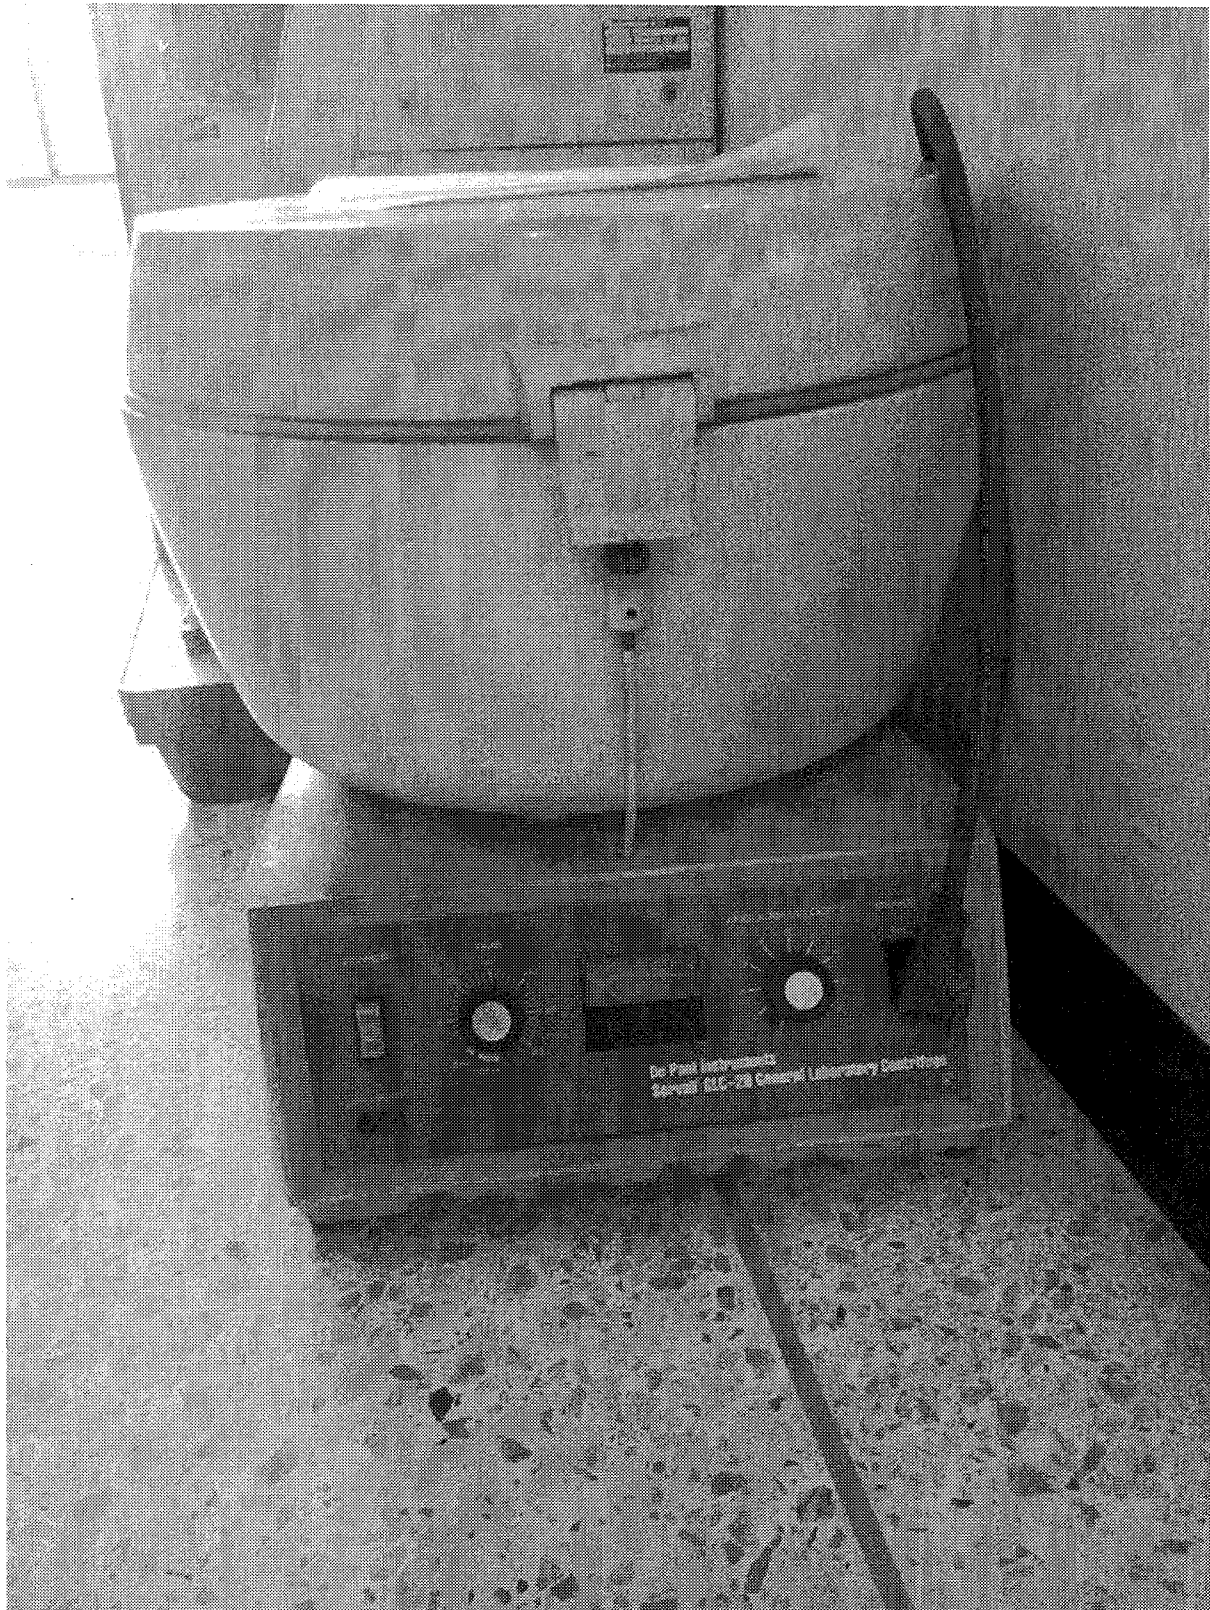

รายการที่ 2 Lyophilizer เครื่องเตรียมเชื้อแห้งเพื่อเก็บระยะยาว รหัสครุภัณฑ์ C-43โอน

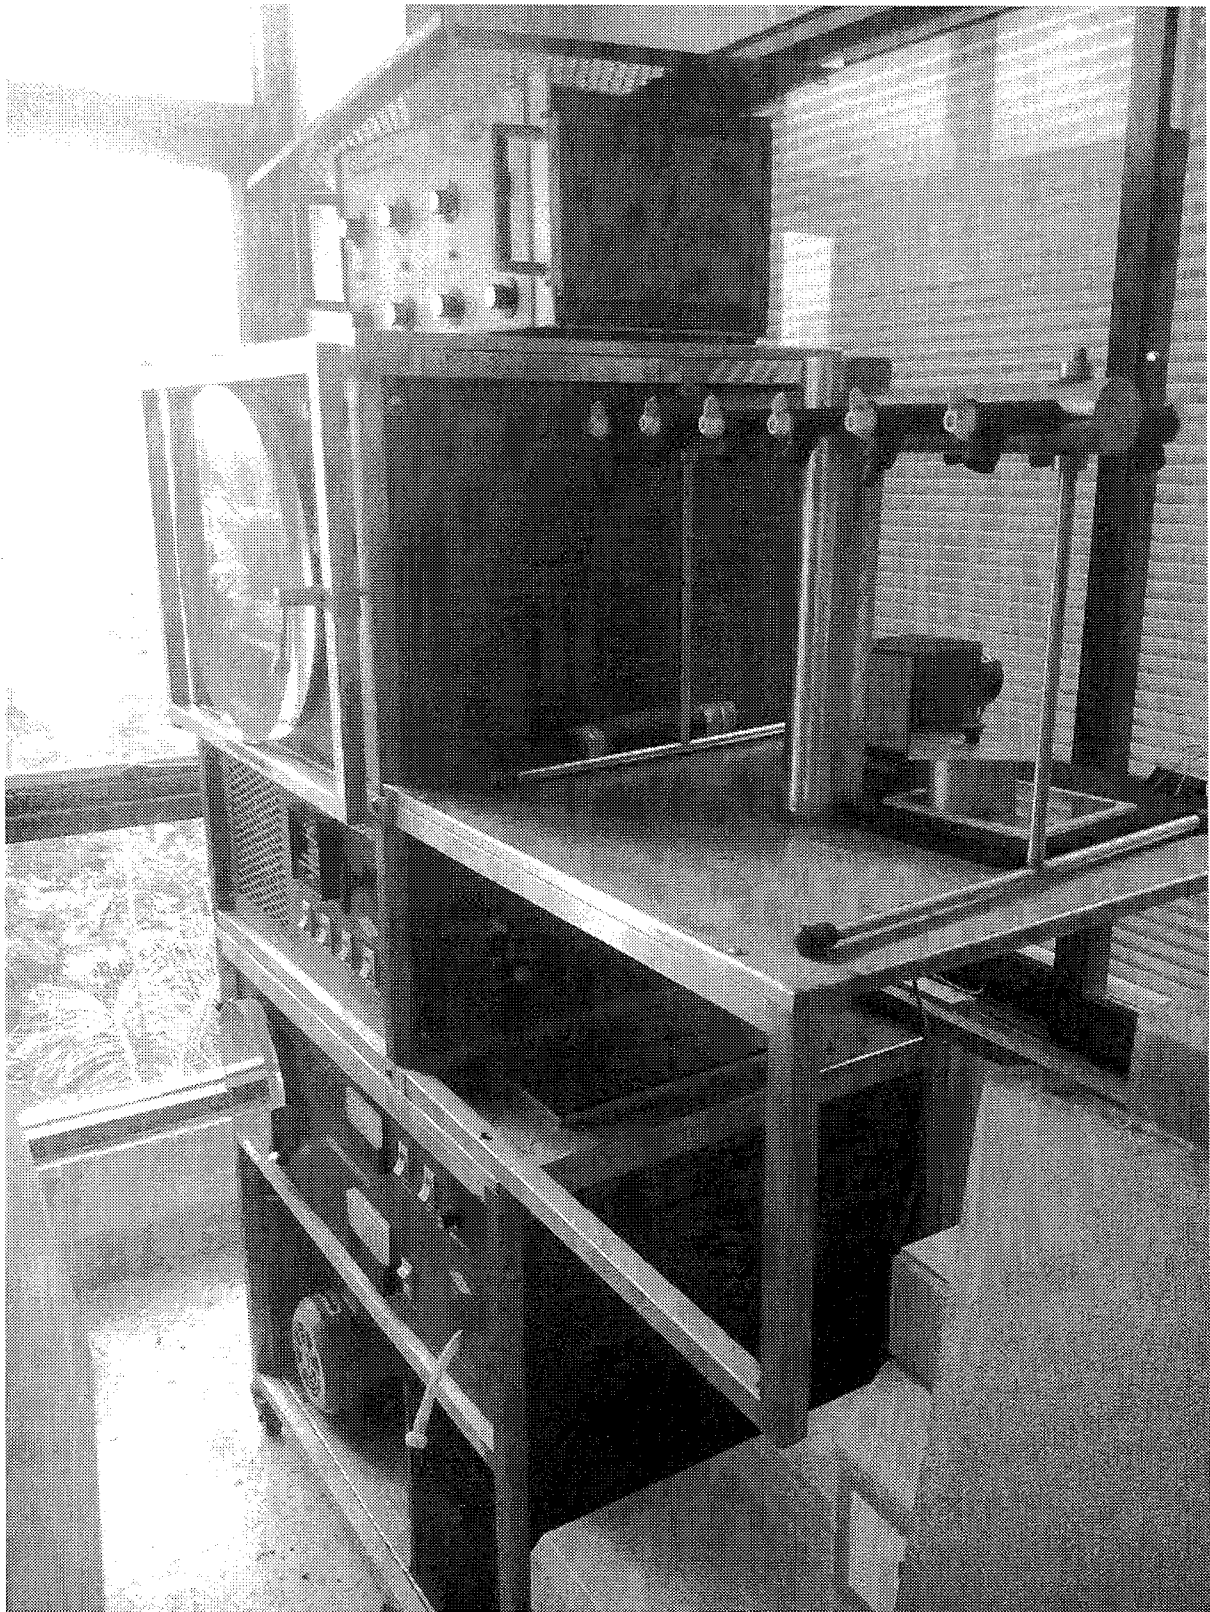


รายการที่ 3 เครื่อง Spectrophotometer รหัสครุภัณฑ์ 36-540514-โอน/1

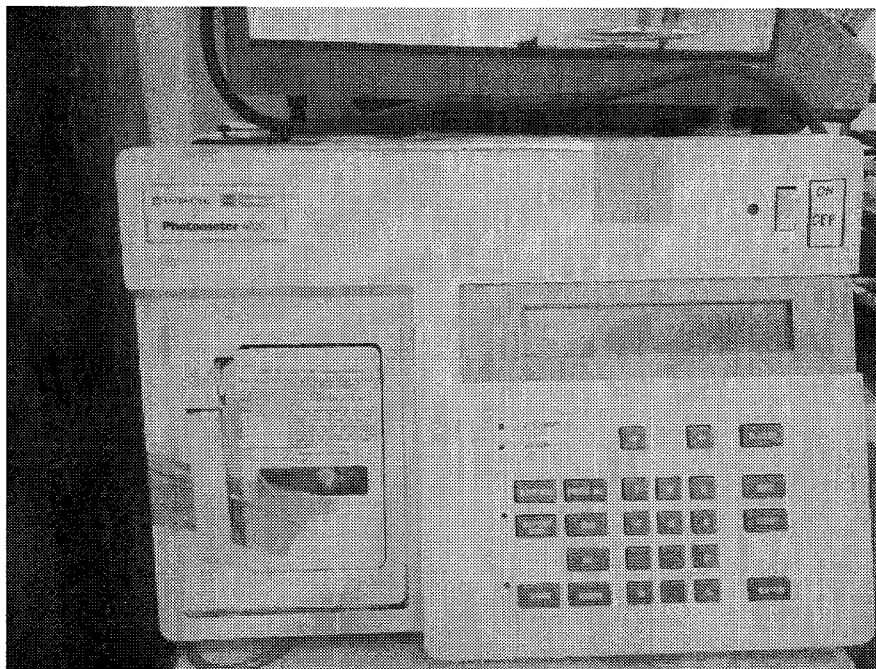


รายการที่ 4 เครื่อง Spectrophotometer รหัสครุภัณฑ์ 36-540514-โอน/2



รายการที่ 5 เครื่องโฟลไซโตมิเตอร์ (Flow cytometry), Coulter Epic Elite, USA ประกอบด้วย Printer Laser HP 5m, เครื่องสำรองไฟ และปรับแรงดันอัตโนมัติ ขนาด 5 KVA, Leonics รหัสครุภัณฑ์ ร38-0785-001-โอน

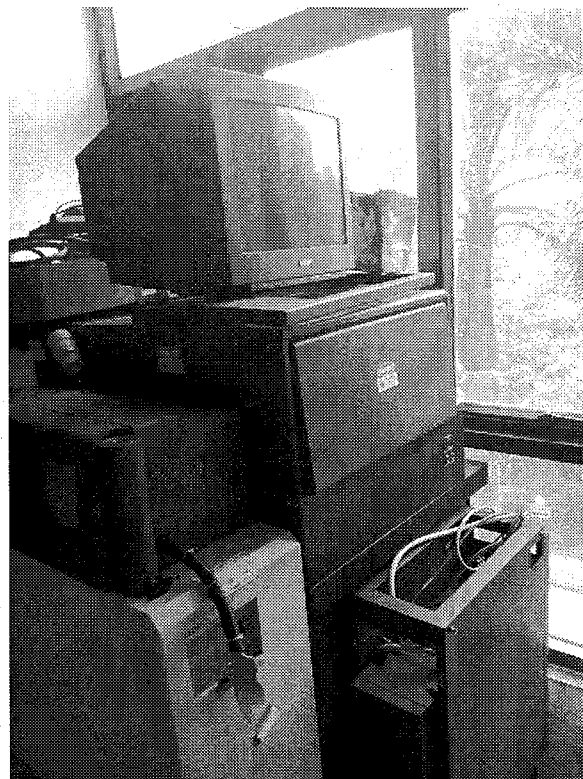


รายการที่ 6 ตู้บเลี้ยงเชื้อคาร์บอนไดออกไซด์ รหัสครุภัณฑ์ 36-0646-001-โอน/1

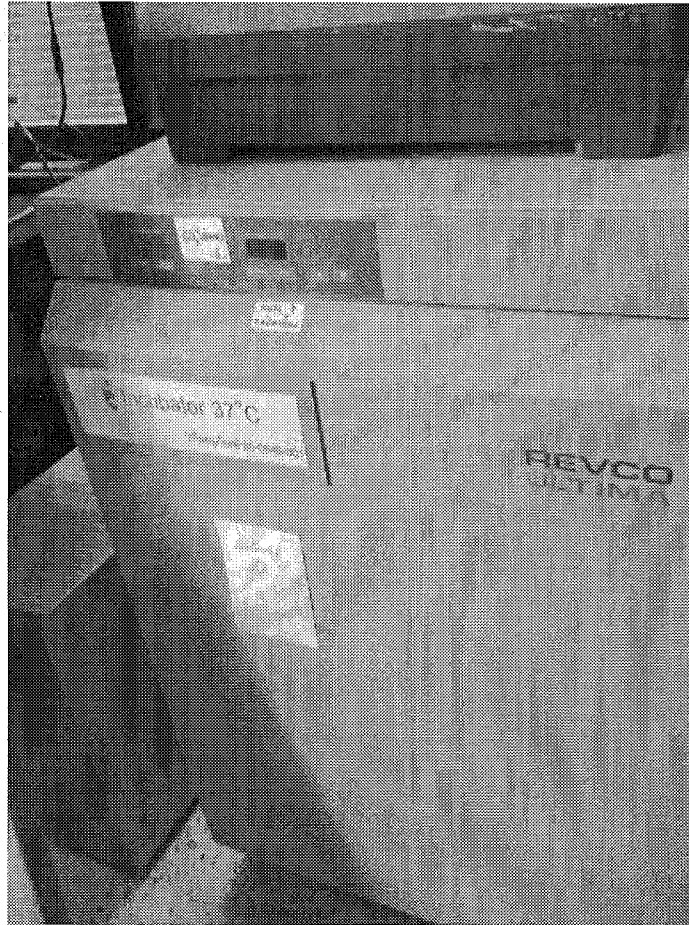


รายการที่ 7 ตู้บเลี้ยงเชื้อคาร์บอนไดออกไซด์ รหัสครุภัณฑ์ 36-0646-001-โอน/2



รายการที่ 8 เครื่อง Trans illuminator รหัสครุภัณฑ์ 35-0611-001-โอน

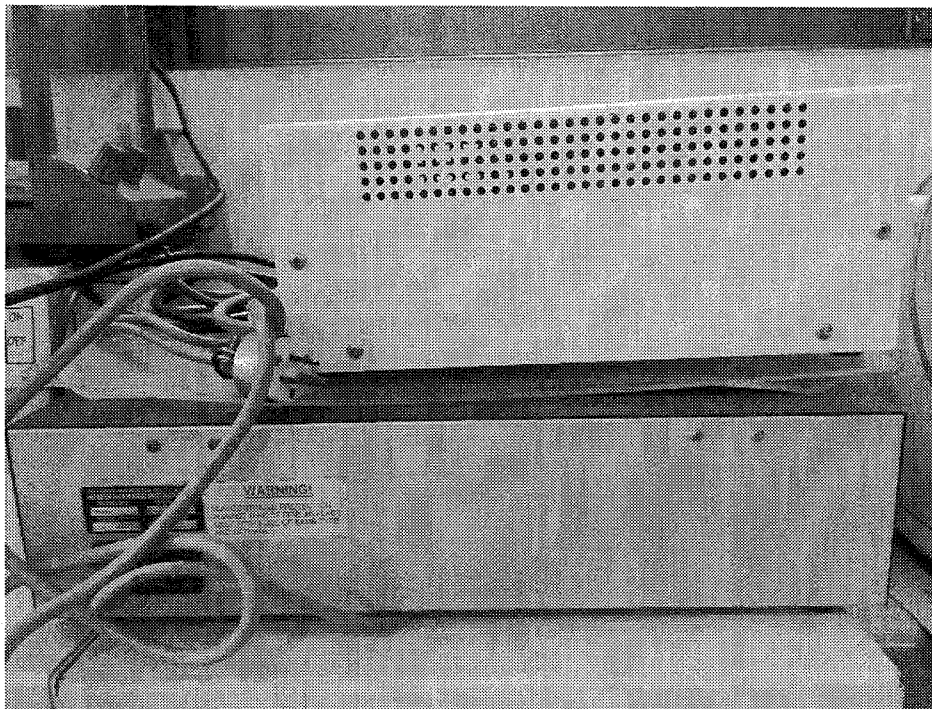


รายการที่ 9 เครื่อง Automatic Analyzer รหัสครุภัณฑ์ C-52-โอน

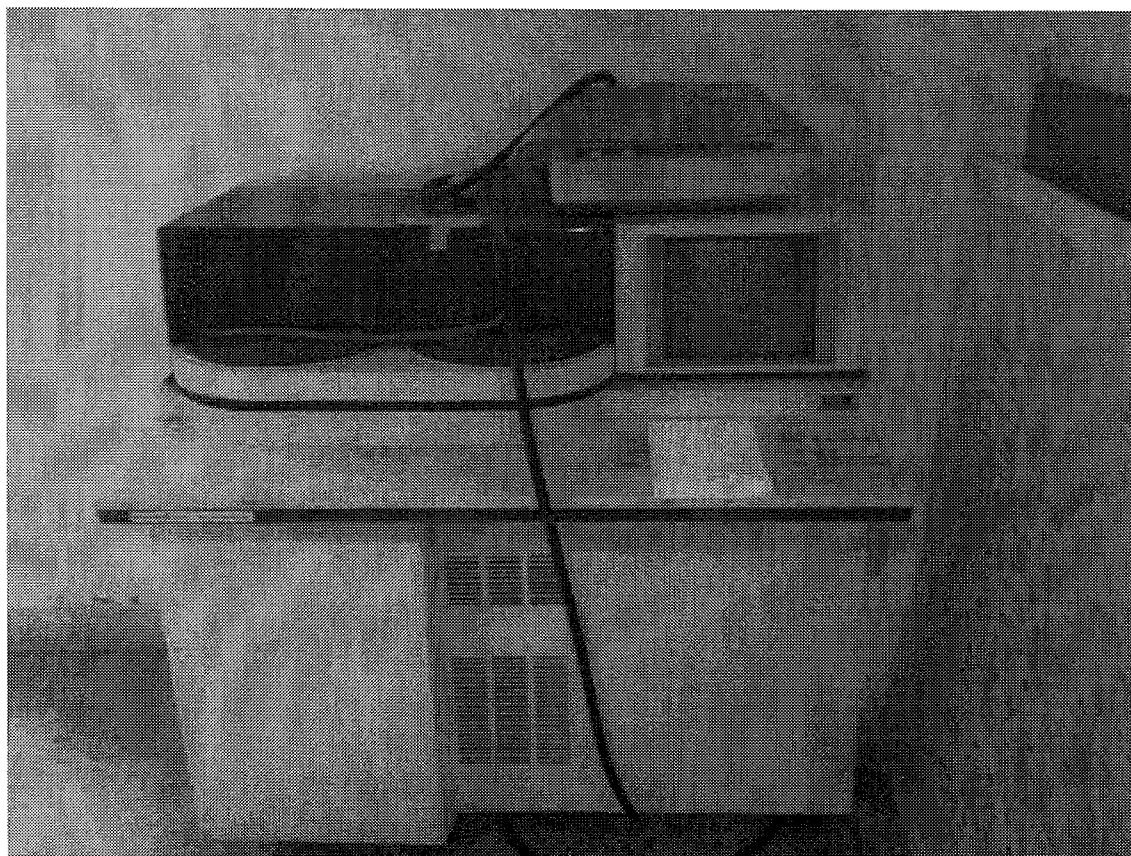

รายการที่ 10 เครื่อง Electrolyte analyzer จำนวน 1 เครื่อง รหัสครุภัณฑ์ MT-NS-โอน-1



รายการที่ 11 เครื่องชั่งอย่างละเอียด รหัสครุภัณฑ์ MT-NS-โอน-2

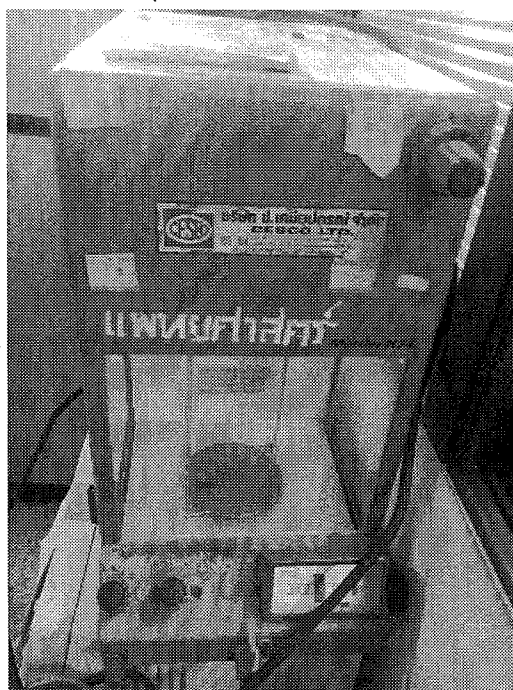

รายการที่ 12 เครื่องแยกชนิดเม็ดเลือด (Haematology) รหัสครุภัณฑ์ MT-NS-โอน-3

